




Tandartsstoel met desinfectie vloeistofklasse 4

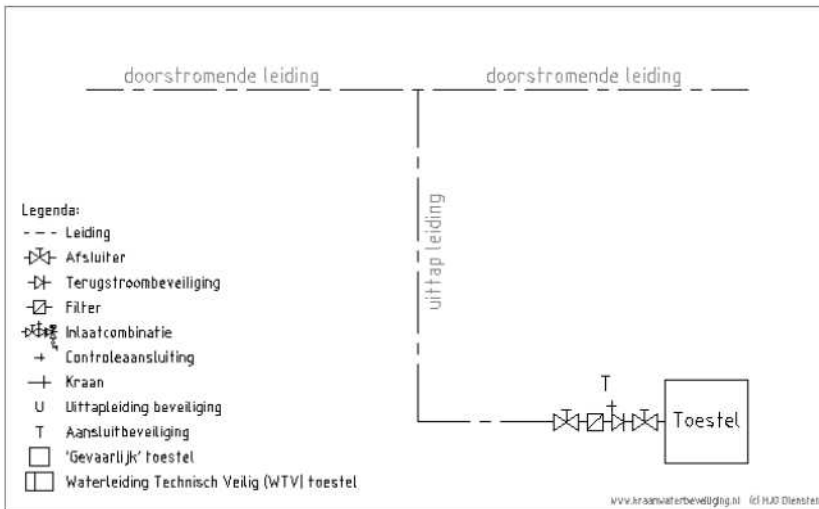

Aansluiting van een tandartsstoel met desinfectie dosering vloeistofklasse 4. Er is geen atmosferische onderbreking ingebouwd.

Wij adviseren minimaal een afsluiter; filter; terugstroombeveiliging type BA en een afsluiter te plaatsen per tandartsstoel. Wijs 'T' aan voor een afbeelding.